

Servicio Navarro de Salud  
Osasunbidea

Instituto de Salud Pública

C. Labe 15  
11003 PAMPLONA-LEONA

Tel. 948 42 94 40  
Fax 948 42 94 41

Instituto de Salud Pública

10 AGO. 1998

SALIDA N.º ..... 3.206 .....


Atendiendo la solicitud presentada por D. José Luis Arranz Gil, de la empresa FALBALAMENDI, S.L., sita en Baracaldo (Vizcaya) para realizar la comprobación de si la placa denominada "CatanDog's" interfiere en la lectura de los microchips de identificación utilizados en animales de compañía, le informo lo siguiente:

Se realizó una prueba con transponder FECAVA, sistema Full Duplex A (FDXA) y con transponder ISO, sistema Full Duplex B (FDXB), efectuando la lectura de los mismos con un lector polivalente ISO, modelo pocket-reader EX, homologado norma ISO 11.785 (lectura FDXB + HDX + FECAVA), en condiciones de temperatura y humedad ambientales, poniendo entre el transponder y el lector primero una placa de las arriba mencionadas, luego dos y así sucesivamente hasta operar de esta manera con veinte a la vez, comprobándose que en ninguno de los casos éstas ni interfieren ni impiden la correcta lectura de los transponders (microchips) de identificación de animales de compañía.

Pamplona, 10 de Agosto de 1998  
JEFE DE SECCION DE SALUD ALIMENTARIA

20.

Julio Fernández de Manzaños

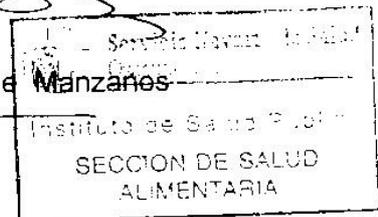

D. José Luis Arranz Gil  
Falbalamendi, S.L.  
C/ Kanpeta nº 2-6º  
48902 BARACALDO (VIZCAYA)